


10.18-10.26



委托单位	南通高盟新材料有限公司
受检单位	南通高盟新材料有限公司

受检单位地址 如东沿海经济开发区高科技产业园二期

采样日期	2022.10.14	检测日期	2022.10.14~2022.10.26
------	------------	------	-----------------------

采样人员	严凯然、黄旭峰	检验人员	范青青、金城邦、 口敏、刘静、王燕
------	---------	------	----------------------

二、附录 2


1. 采样方式为瞬时瞬时超深采样,只代表当时采集样品的水质情况;

2. "ND"表示检测项目浓度低于检出限;

3. "*"表示无资质分包,分包至益铭检测技术服务(济南)有限公司/江苏格林
勒斯检测科技有限公司,证书编号 CMA171512343493/CMA171012050433,

备注 分包报告编号为 TN 20221014020201017201

采样位置编号	检测项目	检测结果			限值
		第一次	第二次	第三次	
	pH 值 (无量纲)	7.94	7.96	7.92	6~9
	氨氮, mg/L	5.21	5.09	4.83	—
DW001	动植物油, mg/L	ND	ND	ND	100
	化学需氧量, mg/L	20	20	25	500
	五日生化需氧量, mg/L	4.7	4.3	5.0	300

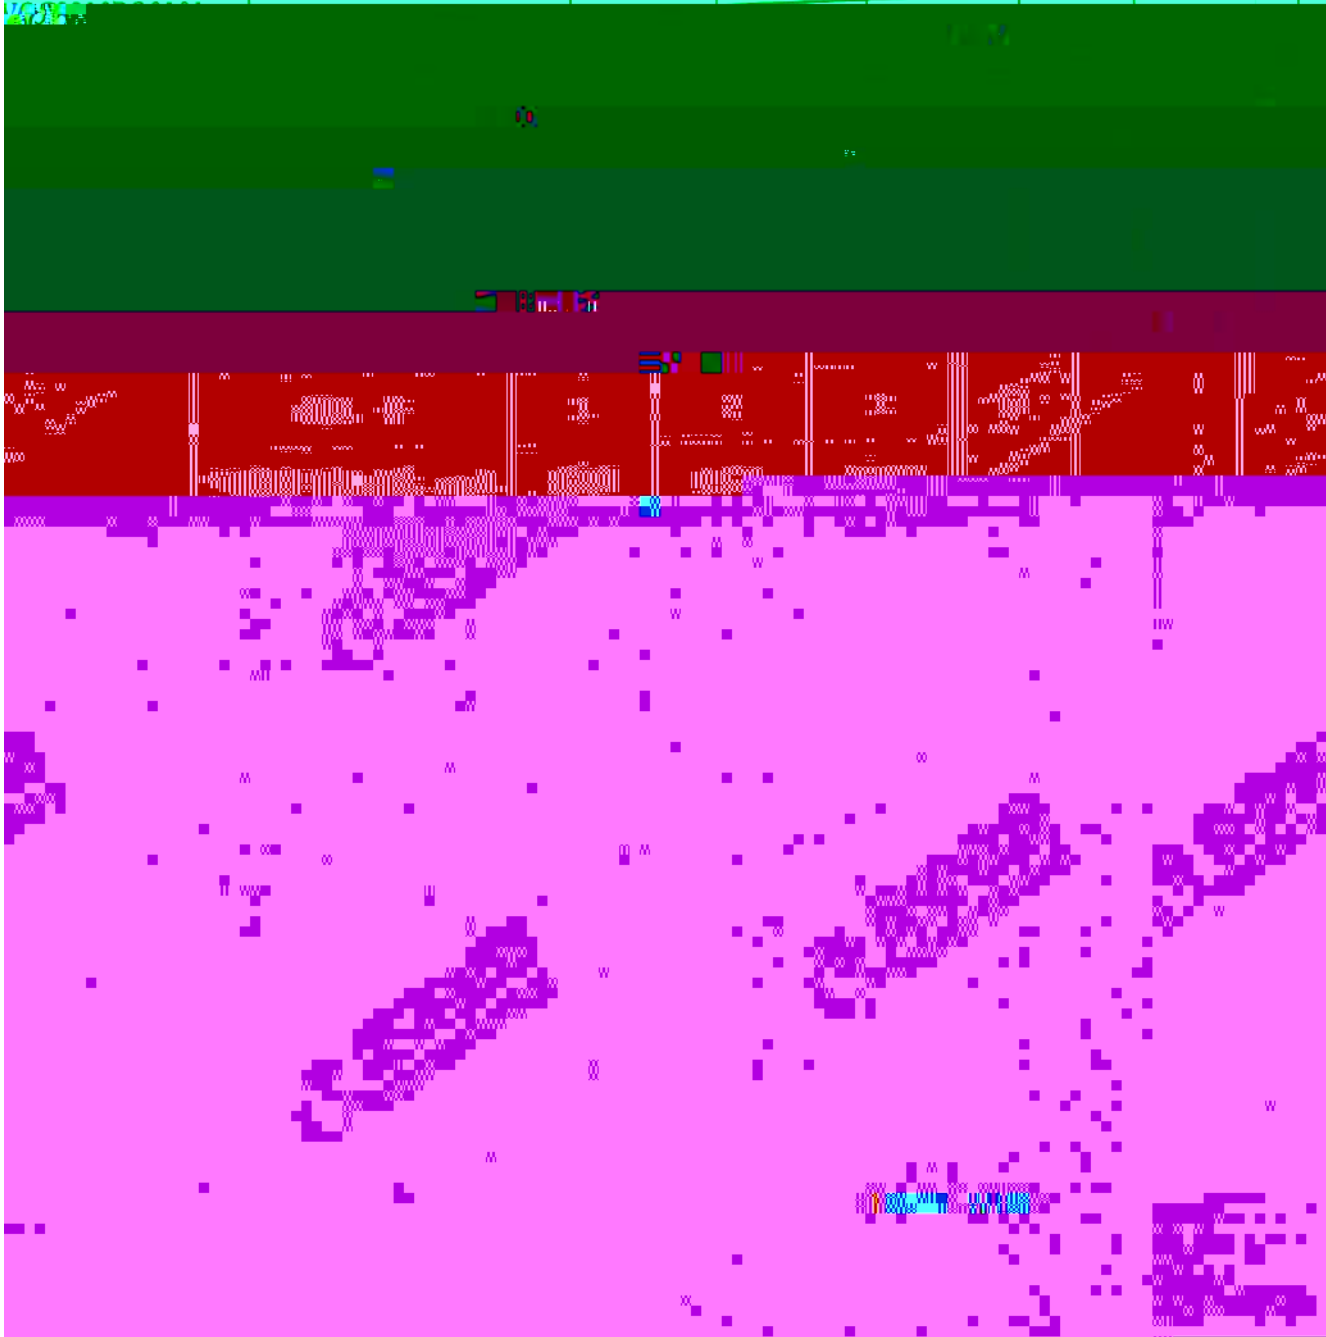

附表: 检测项目方法仪器一览表

序号	检测项目	检测方法	检测仪器
1	甲醛	酚试剂分光光度法	分光光度计
2	苯	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
3	甲苯+乙苯	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
4	二甲苯	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
5	苯系物	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
6	挥发性有机物	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
7	半挥发性有机物	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
8	总挥发性有机物	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
9	总半挥发性有机物	气相色谱-质谱法	气相色谱-质谱仪
10	总有机碳	总有机碳分析仪	总有机碳分析仪
11	氨氮	纳氏试剂分光光度法	分光光度计
12	硝酸盐氮	镉还原分光光度法	分光光度计
13	亚硝酸盐氮	重氮化法	分光光度计
14	总氮	碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法	分光光度计
15	总磷	钼锑抗分光光度法	分光光度计
16	溶解性总磷	钼锑抗分光光度法	分光光度计
17	化学需氧量	重铬酸钾法	分光光度计
18	生化需氧量	五日生化法	生化培养箱
19	高锰酸盐指数	高锰酸钾法	分光光度计
20	浊度	浊度计	浊度计
21	色度	铂钴比色法	分光光度计
22	pH值	pH计	pH计
23	电导率	电导率仪	电导率仪
24	溶解氧	溶解氧仪	溶解氧仪
25	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
26	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
27	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
28	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
29	硫酸根	钡盐重量法	天平
30	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪
31	硝酸盐氮	离子色谱法	离子色谱仪
32	亚硝酸盐氮	离子色谱法	离子色谱仪
33	氨氮	离子色谱法	离子色谱仪
34	总氮	离子色谱法	离子色谱仪
35	总磷	离子色谱法	离子色谱仪
36	溶解性总磷	离子色谱法	离子色谱仪
37	化学需氧量	重铬酸钾法	分光光度计
38	生化需氧量	五日生化法	生化培养箱
39	高锰酸盐指数	高锰酸钾法	分光光度计
40	浊度	浊度计	浊度计
41	色度	铂钴比色法	分光光度计
42	pH值	pH计	pH计
43	电导率	电导率仪	电导率仪
44	溶解氧	溶解氧仪	溶解氧仪
45	总硬度	EDTA滴定法	滴定管
46	钙硬度	EDTA滴定法	滴定管
47	镁硬度	EDTA滴定法	滴定管
48	氯离子	汞盐滴定法	滴定管
49	硫酸根	钡盐重量法	天平
50	氟离子	离子色谱法	离子色谱仪

仪器名称	仪器型号	仪器编号	
电子天平	ME104E /02	QC-JC-023.2	
电子天平	DHG-9140A	QC-JC-042.2	

