



秀色可餐 美味可口 营养健康 绿色生态

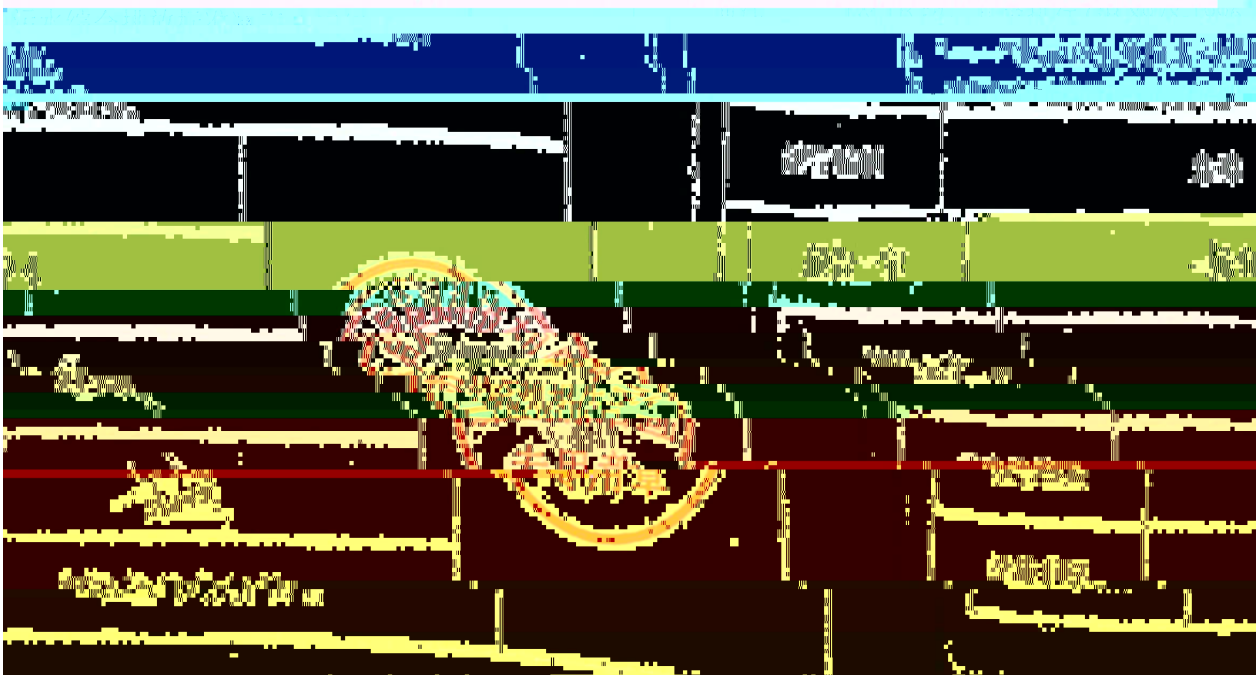

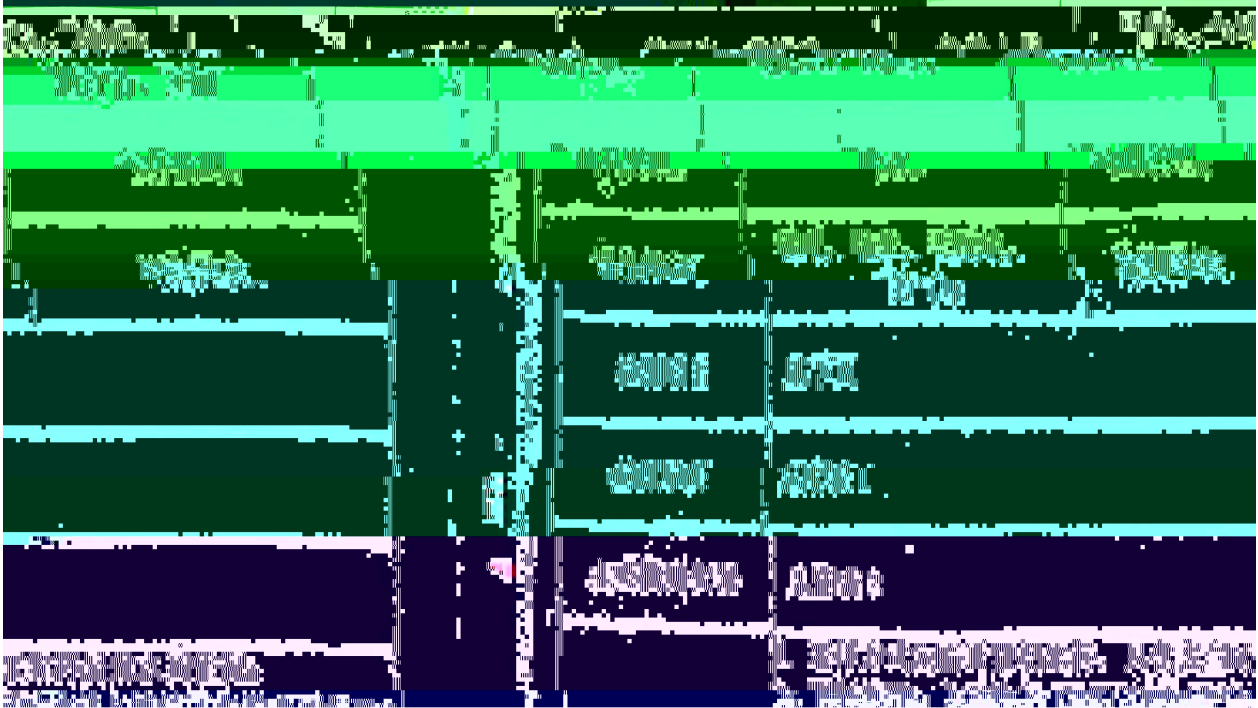

检测结果

序号	名称	规格	单位	检测结果	判定
1	盐酸	优级纯	g/mL	1.19	合格
2	硝酸	优级纯	g/mL	1.42	合格
3	硫酸	优级纯	g/mL	1.84	合格
4	磷酸	优级纯	g/mL	1.71	合格
5	氢氧化钠	优级纯	g/mL	1.33	合格
6	氨水	优级纯	g/mL	0.91	合格
7	过氧化氢	优级纯	g/mL	1.01	合格
8	高锰酸钾	优级纯	g	0.1587	合格
9	重铬酸钾	优级纯	g	0.2942	合格
10	碘酸钾	优级纯	g	0.1660	合格
11	碘化钾	优级纯	g	0.3333	合格
12	亚砷酸钠	优级纯	g	0.1500	合格
13	亚砷酸	优级纯	g	0.1500	合格
14	砷酸	优级纯	g	0.1500	合格
15	砷酸钠	优级纯	g	0.1500	合格
16	砷酸钾	优级纯	g	0.1500	合格
17	砷酸三乙酯	优级纯	g	0.1500	合格
18	砷酸三苯酯	优级纯	g	0.1500	合格
19	砷酸三甲酯	优级纯	g	0.1500	合格
20	砷酸三丁酯	优级纯	g	0.1500	合格
21	砷酸三己酯	优级纯	g	0.1500	合格
22	砷酸三辛酯	优级纯	g	0.1500	合格
23	砷酸三癸酯	优级纯	g	0.1500	合格
24	砷酸三十二酯	优级纯	g	0.1500	合格
25	砷酸三十四酯	优级纯	g	0.1500	合格
26	砷酸三十六酯	优级纯	g	0.1500	合格
27	砷酸三十八酯	优级纯	g	0.1500	合格
28	砷酸四十酯	优级纯	g	0.1500	合格
29	砷酸四十二酯	优级纯	g	0.1500	合格
30	砷酸四十四酯	优级纯	g	0.1500	合格
31	砷酸四十六酯	优级纯	g	0.1500	合格
32	砷酸四十八酯	优级纯	g	0.1500	合格
33	砷酸五十酯	优级纯	g	0.1500	合格
34	砷酸五十二酯	优级纯	g	0.1500	合格
35	砷酸五十四酯	优级纯	g	0.1500	合格
36	砷酸五十六酯	优级纯	g	0.1500	合格
37	砷酸五十八酯	优级纯	g	0.1500	合格
38	砷酸六十酯	优级纯	g	0.1500	合格
39	砷酸六十二酯	优级纯	g	0.1500	合格
40	砷酸六十四酯	优级纯	g	0.1500	合格
41	砷酸六十六酯	优级纯	g	0.1500	合格
42	砷酸六十八酯	优级纯	g	0.1500	合格
43	砷酸七十酯	优级纯	g	0.1500	合格
44	砷酸七十二酯	优级纯	g	0.1500	合格
45	砷酸七十四酯	优级纯	g	0.1500	合格
46	砷酸七十六酯	优级纯	g	0.1500	合格
47	砷酸七十八酯	优级纯	g	0.1500	合格
48	砷酸八十酯	优级纯	g	0.1500	合格
49	砷酸八十二酯	优级纯	g	0.1500	合格
50	砷酸八十四酯	优级纯	g	0.1500	合格
51	砷酸八十六酯	优级纯	g	0.1500	合格
52	砷酸八十八酯	优级纯	g	0.1500	合格
53	砷酸九十酯	优级纯	g	0.1500	合格
54	砷酸九十二酯	优级纯	g	0.1500	合格
55	砷酸九十四酯	优级纯	g	0.1500	合格
56	砷酸九十六酯	优级纯	g	0.1500	合格
57	砷酸九十八酯	优级纯	g	0.1500	合格
58	砷酸一百酯	优级纯	g	0.1500	合格

名称	规格	单位	检测结果
酸式滴定管	50mL		合格
紫外可见分光光度计	TU1900u		合格